

SENKO CO.,LTD



SI-301

방폭형 흡입식 가스감지기

(SI-301) OPERATING MANUAL

! WARNING

기기 사용 전 매뉴얼을 충분히 숙지하십시오. 이 기기는 지시서에 따라 사용하고 보수하여야 하며 지시를 따르지 않을 시 기기 고장을 일으키거나 사용자의 부상 또는 생명에 위험을 초래할 수 있습니다.



Warning

- 위험 지역에서는 제품을 열지 마십시오.
- 센서 홀 표면에 이물질이 있다면 제거 후 사용해 주세요.
- 정기적으로 알람이 정상 작동하는지 알람을 테스트 하십시오.
- 제품 사양에 맞는 사용 온도, 습도, 압력범위 내에서 사용하세요. 이 범위를 벗어나면 기기의 오작동이나 고장의 원인이 됩니다. 장치 내부의 센서는 온도, 압력 및 습도와 같은 환경에 따라 가스 농도를 다르게 표시할 수 있습니다. 반드시 사양과 동일 또는 유사한 환경에서 검지기를 교정하시기 바랍니다.
- 온도의 급격한 변화는 가스 농도의 급격한 변화를 일으킬 수 있습니다(예: 실내외 온도차가 큰 곳에서의 갑자기 사용). 농도가 안정되었을 때에 기기를 사용 하십시오
- 기기에 너무 심한 충격을 가하게 되면 센서 또는 기기의 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 알람은 국제 표준에 따라 설정되며 공인 전문가가 변경해야 합니다.
- FLOW LIMITED DEVICE 장치를 연결해야 하며, 재질은 중합체, 탄성체의 재질이 포함이 되면 안 된다.
- 케이블 연결 시 케이블 인입부에 Ex db 등급의 방폭 케이블 글랜드를 사용해야 합니다.
- LAN 케이블(PoE) 사용 시 'Ex db' Barrier Type의 케이블 글랜드 또는 실링 피팅을 사용하여야 합니다.(8코어 이상 사용)



Caution

- 사용 설명서를 충분히 숙지한 후에 사용하여 주세요.
- 본 제품은 가스 측정기가 아니라, 가스 감지기입니다.
- 보정 실패가 연속적으로 발생할 경우 사용을 중단하고 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.
- 방염 조인트는 수리할 수 없습니다.
- 화염경로에 대한 자세한 내용은 제조업체에 문의 하십시오.
- LAN케이블 사용시 Shield 케이블(STP)을 사용해 주시기 바랍니다



Warranty

(주)센코는 SI-301 Series 제품을 제품 출하일로부터 24개월간 보증하며 보증기간 중 이상이 있는 제품은 (주)센코에서 수리 또는 교환을 보증 합니다. 단, 센서 및 배터리 또는 램프 등 사용량에 따라 제품의 수명이 짧아지는 부품들은 이 보증기간에 적용되지 않으며, (주)센코가 인정하지 않는 경로로 제품을 구입한 경우, 소비자의 잘못된 사용에 의해 제품의 기계적 손상과 변형이 발생한 경우, 그리고 사용 설명서의 절차대로 보정 또는 부품 교체를 하지 않은 경우에 발생하는 고장의 경우에는 무상으로 수리 또는 교환을 받을 수 없습니다. 또한 보증기간 동안 제품의 하자 또는 품질에 문제가 생길 경우 즉각 제조사에 고지하여야 하며 운송비를 제외한 모든 비용은 (주)센코가 부담합니다. 보증기간이 지난 후의 제품 또는 부품의 수리, 교환, 운송 등의 비용은 사용자 부담을 원칙으로 합니다. (주)센코는 제품을 사용하면서 발생하는 간접적 또는 우발적 사고나 손실에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않으며, 보증은 부품과 제품의 교환에 한정합니다. 이 보증은 (주)센코에서 지정한 공인된 영업소나 대리인에게서 제품을 구입한 사용자에게만 해당하며 보증수리는 숙련된 기술자가 있는 (주)센코의 지정된 A/S 센터를 통해 이루어져야 합니다.

index

1. 제품소개	5
1.1. 가스 감지기 사양.....	5
1.2. 센서리스트	6
1.3. 구조	7
2. 외형의 명칭 및 설명	8
2.1. 구성요소.....	8
2.2. 전면 Display 구성	10
3. 설치방법	11
3.1. 전원, RS485, 4-20mA 단자 구성.....	11
3.1.1. DC Terminal	11
3.1.2. RS485 Terminal.....	12
3.1.3. 4-20mA Terminal.....	12
3.1.4 PoE Ethernet Terminal.....	12
3.2. Alarm 단자 구성.....	12
3.3.1. Fault Relay 출력구성.....	12
3.3.2. Low Relay 출력구성	13
3.3.3. High Relay 출력구성.....	13
3.3 접지 구성.....	13
4. 작동방법	14
4.1. Power On	14
4.2. 가스 측정 상태 (Measure Mode).....	14
4.3. 내부 설정 진입	15
5. System Mode	15
5.1. 모드 구성.....	15
5.2. 메뉴 상세 구성	16
5.3. Setting/Configuration Menu.....	17
5.4. Setting/Measurement Menu	20
5.5. Setting/Calibration Menu	21

5.6. Setting/Alarm Menu	22
6. 문제 해결.....	24
6.1. Error code.....	24
7. Interface 구성.....	25
7.1 RS485 Interface setting.....	25
7.2 TCP Interface setting.....	25
7.3 MODBUS RS485/TCP Register.....	25
● 3010X Register Read.....	25
● 4000X Register Read.....	26
● 4000X Register Write.....	28
8. Maintenance	29
8.1 가스 테스트.....	29
8.2 감지기 작동 수명.....	29
9. 외형도 및 Dimensions	30
10. 설치 시 주의 사항	31
10.1 설치 장소의 선정.....	31
10.2 설치 위치의 선정.....	31
10.3 A/S 연락처.....	31
11. Certification	32
11.1 Related standards.....	32
12. 개정이력.....	32

1. 제품소개

1.1. 가스 감지기 사양



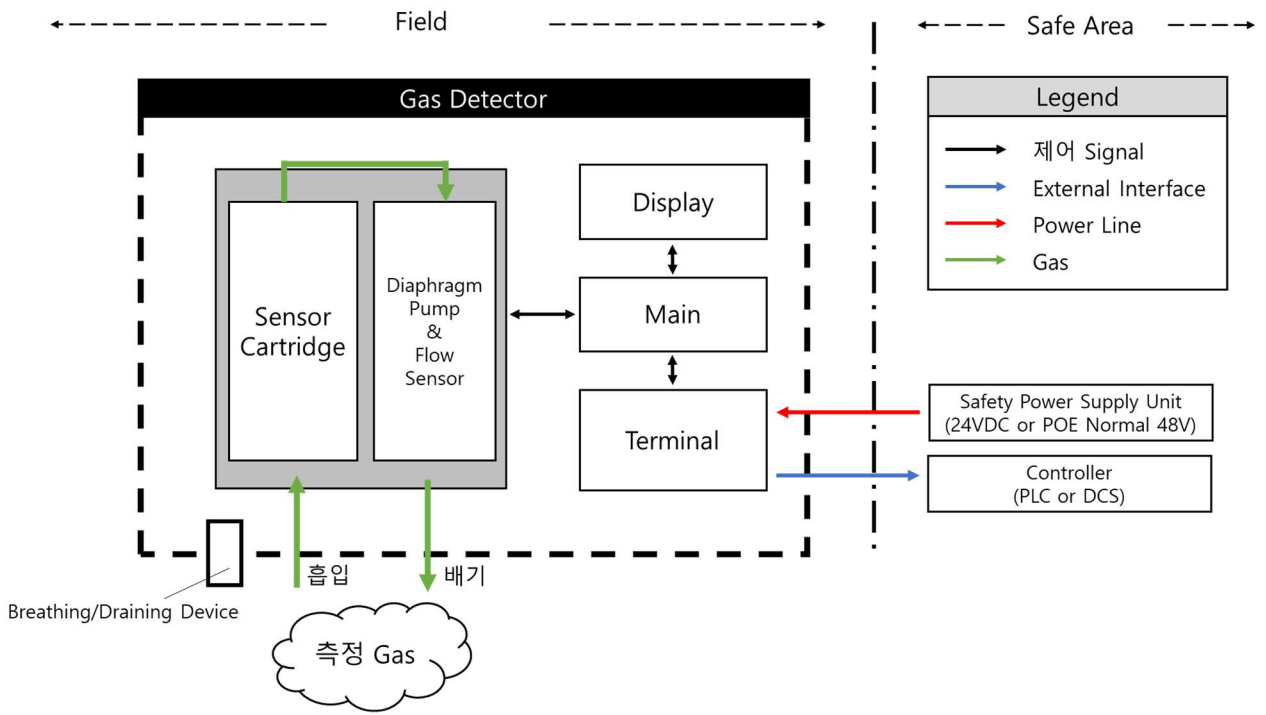
- 내압방폭 구조
- 카트리지 형태 센서 - 유지보수 용이
- 유량 조절기능 내장
- 4-Digit 디지털 농도 표시 및 디지털 유량 표시
- 4-20mA / RS-485 / Ethernet

항 목	사 양
크기	194mm(W) X 152.4mm(D) X 136mm(H)
중량	4Kg
동작 전압	DC : 24V ± 10% PoE : 36V~57V (Typical : 48V)
유량	100 ~ 1,000 ml (Normal 300 ~ 500ml / min)
소비 전력	약 5.0W
측정 표시	FND, 가스농도, 유량, 알람, 경보, 기기 이상
Relay	1차 Alarm, 2차 Alarm, Fault Alarm
Analog 측정 출력	4-20mA
Digital 통신	RS-485, TCP Ethernet
샘플링 거리	입력 가스 튜브 길이 : 최대 30m (FEP 튜브) 배출 가스 튜브 길이 : 최대 30m (FEP 튜브)
입/출력 튜브 규격	1/4" Teflon tube
사용 온도	-40°C ~ 55°C
인증	Ex db IIC T6 Gb
IP	IP 65 (KS C IEC60529:2013)
입력 및 세팅	4 Button & RS485 & Ethernet & Bluetooth
기기 보증기간	2년
센서 카트리지 보증기간	1년
원격 인터페이스	Ethernet , RS-485, HART(Optional)
배선	4 to 20mA / DC전원 / Relay : 최대 14 AWG
압력 범위	90 to 110KPa
샘플 최대 유량	Max. 1,000 ml
샘플 최대 압력	3KPa

1.2. 센서리스트


Gas		Sensor	Range	A1	A2	Resolution
Oxygen	O ₂	Electrochemical	0~30%Vol	19.0%vol	23.0%vol	0.1%vol
Carbon Monoxide	CO	Electrochemical	0~500ppm	30ppm	60ppm	1ppm
Sulfur Dioxide	SO ₂	Electrochemical	0~20ppm	2ppm	5ppm	0.1ppm
Hydrogen	H ₂	Catalytic	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Hydrogen	H ₂	Electrochemical	0~1000ppm	100ppm	500ppm	within 5ppm
Hydrogen Sulfide	H ₂ S	Electrochemical	0~500ppm	10ppm	15ppm	1ppm
Combustible	-	Catalytic	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Combustible	-	IR	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Ammonia	NH ₃	Electrochemical	0~100ppm	25ppm	35ppm	1ppm
Acetylene	C ₂ H ₂	Catalytic	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Ethanol	C ₂ H ₆ O	Catalytic	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Toluene	C ₇ H ₈	IR	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Toluene	C ₇ H ₈	Catalytic	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Methane	CH ₄	IR	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Methane	CH ₄	Catalytic	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Chlorine	Cl ₂	Electrochemical	0~5ppm	0.5ppm	1.0ppm	0.1ppm
Chlorine	Cl ₂	Electrochemical	0~20ppm	0.5ppm	1.0ppm	0.1ppm
Carbon Dioxide	CO ₂	IR	0~2000ppm	1000ppm	1500ppm	3ppm
Carbon Dioxide	CO ₂	IR	0~5000ppm	3000ppm	5000ppm	8ppm
Carbon Dioxide	CO ₂	IR	0~5%Vol	0.5%vol	3%vol	0.1%vol
Hydrogen Chloride	HCl	Electrochemical	0~10ppm	1ppm	2ppm	0.1ppm
VOC	VOC	PID	0~1000ppm	50ppm	100ppm	within 3ppm
Xylene	C ₈ H ₁₀	IR	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Hydrogen peroxide	H ₂ O ₂	Electrochemical	0~10ppm	1ppm	2ppm	0.1ppm
Nitrogen Dioxide	NO ₂	Electrochemical	0~20ppm	3ppm	5ppm	0.1ppm
Ethylene oxide	C ₂ H ₄ O	Electrochemical	0~30ppm	1ppm	2ppm	0.1ppm
Ethylene	C ₂ H ₄	Catalytic	0~100%LEL	15%LEL	50%LEL	1%LEL
Nitrogen Monoxide	NO	Electrochemical	0~100ppm	25ppm	50ppm	1ppm
Hydrogen fluoride	HF	Electrochemical	0~5ppm	0.5ppm	1ppm	0.1ppm

1.3. 구조




2. 외형의 명칭 및 설명

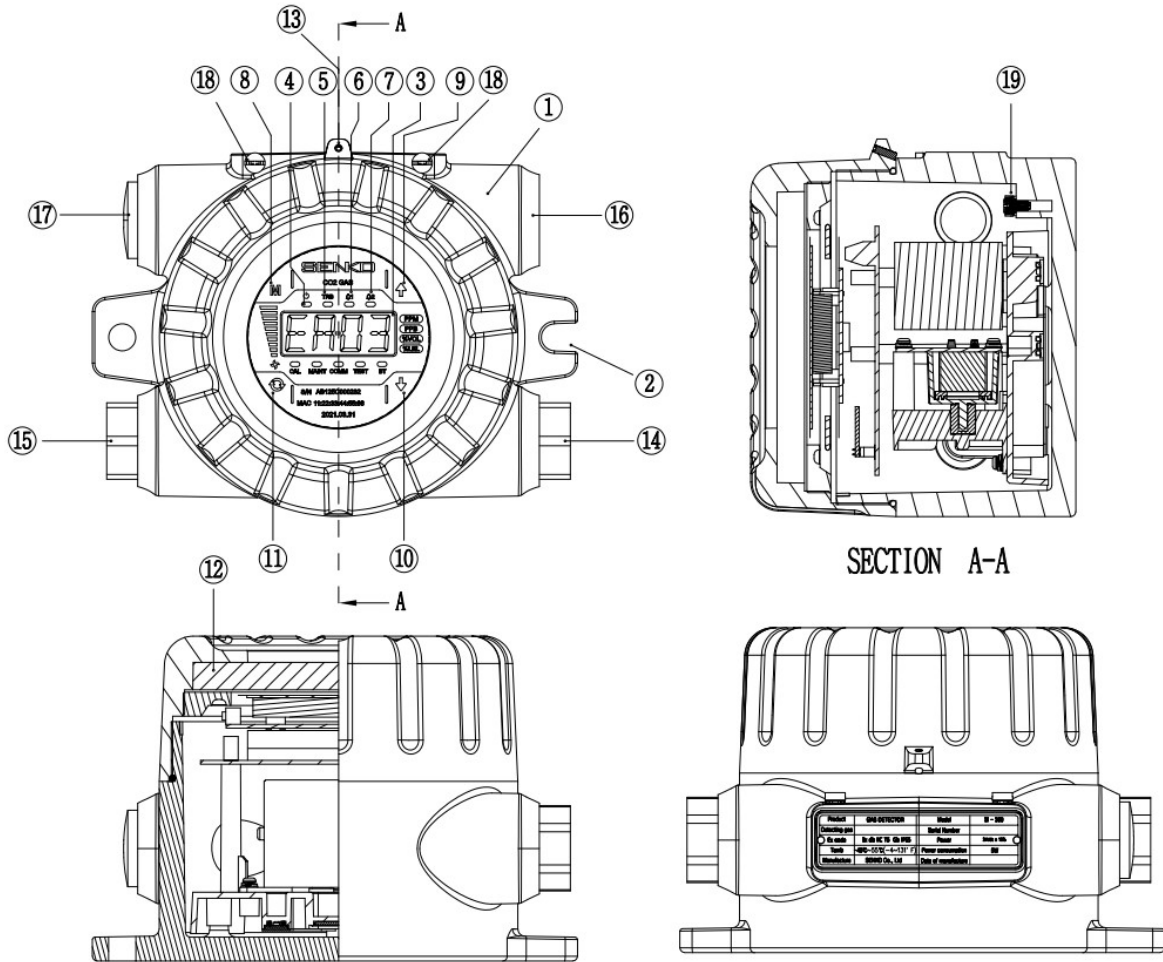2.1. 구성요소



NO	NAME	DESCRIPTIONS
1	Case cover	Sensor 와 제품 내부에 내장되어 있는 PCB board 및 Sensor 등을 외부의 환경변화 및 충격으로부터 보호한다.
2	Mount Holes	제품 고정에 사용되는 Mounting hole이다.
3	FND display	Sensor에서 측정되는 가스 농도 값 및Parameter설정시 설정 Mode를 숫자 및 Icon으로 표시해 준다. (상세설명 "전면부 LED Display 구성"을 참고한다.)
4	Power LED	전원(DC 24V)이 정상적으로 공급되면 Green LED가 점등 된다.
5	Trouble LED	Sensor 및 유량 등이 고장으로 인식될 때 Yellow LED가 점등되며, 설정 시 외부로 Trouble relay 접점 Signal 이 출력된다.
6	Alarm1 LED (Red)	측정가스 농도가 Alarm1 설정치 이상이 되면 LED 가 점등되고, 설정 시 외부로 Relay 접점 Signal 이 출력된다. (Alarm1 level 설정은 Alarm 설정 Mode에서 임의로 설정가능 하다.)
7	Alarm2 LED (Red)	측정가스 농도가 Alarm2 설정치 이상이 되면 LED 가 점등되고, 설정 시 외부로 Relay 접점 Signal 이 출력된다. (Alarm2 level 설정은 Alarm 설정 Mode에서 임의로 설정가능 하다.)
8	Menu key	기능 설정 Mode에서 Mode 전환 및 설정 key이다. 측정 상태에서 Menu key를 1초 이상 누르고 있으면 기능 설정 Menu로 진입한다. (Configuration, Measurement, Calibration, Alarm, 등)
9	Up key	기능 설정 Mode에서 설정 값을 올려주는 key이다.
10	Down key	기능 설정 Mode에서 설정 값을 내려주는 key이다.
11	Select key	기능 설정 Mode에서 메뉴상태 설정할 때 Select key를 사용한다. 측정상태에서 3 Sec 이상 Select key와 Down key를 동시에 누르고 있으면 점검 Mode로 진입하며 TEST LED 가 점멸한다.
12	Window Glass	Housing 내 제품상태를 알려주는 Display 상태를 볼 수 있게 해주는 강화 Glass이다.
13	Cover fixed screw	Main body case 와 Front cover case를 고정시켜주는 screw이다.
14	Gas inlet	Sample gas inlet port이다. (1/4" Tube)
15	Gas outlet	Sample gas output port이다. (1/4" Tube)
16	Cable gland	전원 및 signal Cable 인입구이다.
17	Breathing Device	Flame arrestor기능의 Breather / Ex d IIC Air Breather(SAB) 인증번호 17-GA2BO-0697U
18	External earth	외부의 Noise 혹은 강전계로부터 보호하기 위한 외부 접지 접지선은 4mm 이상의 도체를 사용하여 결합 접속한다
19	Internal earth	외부의 Noise 혹은 강전계로부터 보호하기 위한 내부 접지 접지선은 4mm 이상의 도체를 사용하여 결합 접속한다

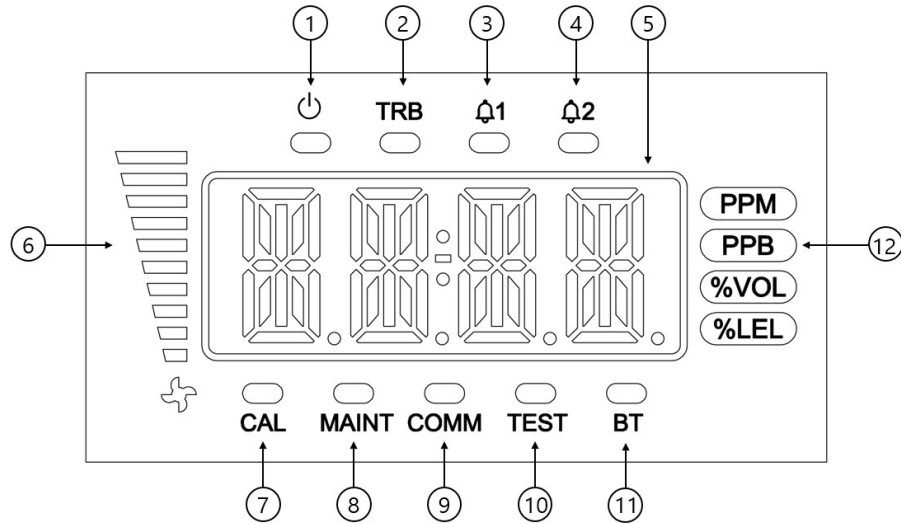2.2. 전면 Display 구성



No	Name	Descriptions
1	Power LED(Green)	전원(DC 24V)이 정상적으로 공급되면 LED가 점등.
2	Trouble LED	Gas detector 자체 진단 시 Fault 감지되었을 경우 표시
3	Alarm1 LED	Alarm1 설정 또는 감지되었을 경우 표시
4	Alarm2 LED	Alarm2 설정 또는 감지되었을 경우 표시
5	FND DISPLAY	Sensor에서 측정되는 가스 농도 값 및 Parameter 설정 시 설정 모드를 숫자 및 아이콘으로 표시
6	FLOW LED	현재 유량을 graph bar 로 표시
7	CAL LED	교정 진행 시 표시
8	MAINT LED	Engineering mode 실행 시 표시
9	COMM LED	RS485/Ethernet 통신 시 표시
10	TEST LED	점검 모드 실행 시 표시
11	BT LED	Bluetooth 연결 시 표시


[Table 2. 전면부 Display 구성요소 설명]

3. 설치방법

⚠ 현장에 설치하거나 가스누설 감지기의 Cover를 열거나 조작하는 것은 현장 가스 분위기에 따라 화재나 폭발사고 등으로 인해 인명 및 재산상의 피해를 입을 수 있습니다. 그러므로 주위에 폭발 성 잔류 가스가 있는지 여부를 확인한 후 전원을 끈 상태에서 안전하게 작업을 진행하여야 합니다.

3.1. 전원, RS485, 4-20mA 단자 구성

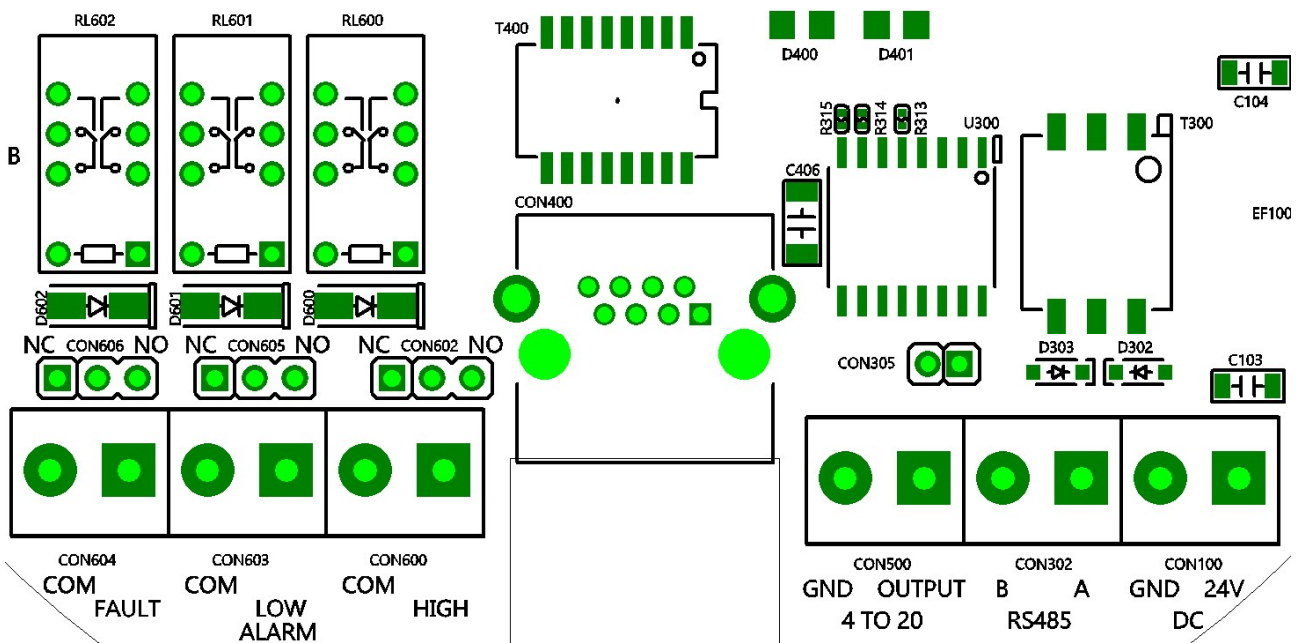- Detector 옆면에 있는 Case cover 고정 screw를 풀고, Case cover를 분리한다. 그러면 Terminal 단자가 나타난다.



3.1.1. DC Terminal

- DC 단자는 감지기 전원을 위한 단자로 구성된다.

Pin No.	단자명	설명
1	GND	Ground
2	24V	Power

- 1.5sq 이상 Shield cable를 사용해야 한다.
- 외부 파워(DC24V)를 사용할 경우 Terminal Unit의 'CON100' Terminal 단자에 연결한다.

3.1.2. RS485 Terminal

- RS-485A, RS-485B에 아래와 같은 MODBUS Master 단자에 연결한다.

Pin No.	단자명	설명
1	B	TRXD ⁻ 또는 B 또는 N
2	A	TRXD ⁺ 또는 A 또는 P

3.1.3. 4-20mA Terminal

- 4-20mA 단자는 4-20mA 출력을 위한 단자로 구성된다.

Pin No.	단자명	설명
1	GND	4~20mA Ground
2	OUTPUT	4~20mA Output Signal

3.1.4 PoE Ethernet Terminal

- PoE 단자는 PSE와 감지기를 LAN CABLE(CAT5 Cable or equivalent RJ45)을 통하여 연결한다.

Pin No.	단자명	설명
CON400	RJ-45 JACK	PoE & Ethernet Connected

3.2. Alarm 단자 구성

- 단자에 연결된 Alarm Relay 를 아래의 구성을 사용하여 연결한다.

3.3.1. Fault Relay 출력구성

단자명	Fault Relay Contact	Jumper 설정
FAULT-OUT	Normal Close Mode	J7 Jumper NC on
	Normal Open Mode	J7 Jumper NO on
FAULT-COM	Common	-

3.3.2. Low Relay 출력구성

단자명	Fault Relay Contact	Jumper 설정
AL1-OUT	Normal Close Mode	J6 Jumper NC on
	Normal Open Mode	J6 Jumper NO on
AL1-COM	Common	-

3.3.3. High Relay 출력구성

단자명	Fault Relay Contact	Jumper 설정
AL2-OUT	Normal Close Mode	J3 Jumper NC on
	Normal Open Mode	J3 Jumper NO on
AL2-COM	Common	-

3.3 접지 구성

- 내부접지 : 링터미널을 이용해 내부접지 1-포인트에 접지를 할수 있다.



- 외부접지 : 링터미널을 이용해 외부접지 2-포인트에 접지를 할수 있다.

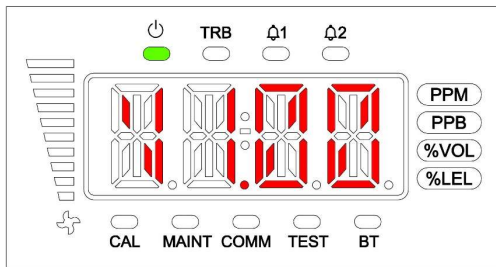


※ 접지선은 직경 4mm 이상의 도체를 사용하여 결합 연결한다.

4. 작동방법

4.1. Power On

- 결선 확인, 전원 전압을 확인한 후에 Power 스위치를 ON 한다.
- Power LED(Green) 및 Version 정보(ex V1.00)가 점등된 후, 측정(Measure)상태로 전환된다.
- 소요시간은 약 3분 내외 경과 한다. 기기 준비 동작 중 MENU 키를 누르면, 바로 측정(Measure) 상태로 전환한다.



4.2. 가스 측정 상태 (Measure Mode)

	<p>알림 LED</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Power/Trouble/Alarm 1/Alarm2 <p>현재 가스 농도 표시</p> <p>가스 농도 단위 표시</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 측정 범위에 따라 소수점 자리 변경 <p>현재 Pump 유량 표시</p> <p>Pump 유량</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 현재 흡입하는 유량 <p>기기 상태 LED</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ CAL : Calibration 진행 ▶ MAINT : 유지 보수 진행 ▶ COMM : 통신 상태 ▶ TEST : Test 진행 ▶ BR : Bluetooth 연결 상태
	<p>Trouble(Fault) 상태</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 기기 문제 발생 시 Trouble LED 점등 ▶ 6.1. Error Code 참조

4.3. 내부 설정 진입

	<p>▶ 측정상태에서 Menu Key를 1초 이상 누르면 암호 요구 상태로 진입</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 암호 요구 화면 진입 후 [**] 표시 2. 초기 값은 [00]이며 Up/Down Key로 [00]~[99]까지 변경 가능 비밀 번호 입력 후 Select Key를 누르면 내부 설정으로 진입 가능하다.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 내부 설정 모드에서는 Up/Down Key로 각각의 설정으로 진입 가능하다. 2. CFG/MEAS/CAL/ALM 설정 가능

5. System Mode

5.1. 모드 구성

해당 장비는 다음과 같은 형태의 메뉴 구성으로 이루어진다

구분	표시	설명	비고
CONFIGURATION	CFG	기본 설정	
MEASUREMENT	MEAS	측정 설정	
CALIBRATION	CAL	가스 교정 설정	
ALARM	ALM	알람 설정	
TEST	TEST	테스트	Engineering Mode
TIME	TIME	시간 설정	Engineering Mode

FLOW	FLOW	펌프 Flow 설정	Engineering Mode
NETWORK	NET	Ethernet 설정	Engineering Mode
ADJUST	ADJ	4-20mA 교정 설정	Engineering Mode
FACTORY	FACT	공장 설정	Engineering Mode

[Table 4. Mode Configuration]

5.2. 메뉴 상세 구성

장비 전체 메뉴 구성은 하기와 같다

1 Depth	2 Depth	3 Depth	Default
CFG (Configuration)	GAS	현재 가스 센서 종류	-
	HART	HART Board 장착 유무	-
	MODT	Modbus Type(RTU/TCP)	TCP
	ADR(Address)	Modbus Address(0~64)	1
	PWD>Password)	비밀번호 설정(00~99)	00
	C-TM(Calibration Time)	Calibration 주기 (1~12개월)	12
	HIDN(Hidden Area)	측정값 숨김 영역 (Full Range 기준 0~20%)	03%
	BRIT	FND Brightness	5
	M1.00	펌웨어 버전	-
	S1.00	센서 카트리지 버전	-

1 Depth	2 Depth	3 Depth	Default
MEAS (Measurement)	DECP(Decimal Point)	측정 소수점 자릿수(1000, 100.0, 10.00, 1.000)	100.0
	F-RN (Full Range 1~9999)	측정 Full Range(1~9999)	100
	UNIT	가스 측정 단위 (PPB, PPM, VOL%, %LEL)	PPM

1 Depth	2 Depth	3 Depth	Default
CAL (Calibration)	ZERO (Zero Calibration)	영점 교정	가스 별 상이
	S-CN (Span Concentration)	교정 가스 농도 설정(1~9999)	가스 별 상이
	SPAN (Span Calibration)	가스 교정	가스 별 상이

1 Depth	2 Depth	3 Depth	Default
ALM (Alarm)	LACH(Latch)	Alarm Latch(ON, OFF)	OFF
	ENER(Energized)	Alarm Energized(EN, D-EN)	EN
	DLY(Delay)	Alarm Delay(0~99초)	0
	ALM1(Alarm level 1)	Alarm 1 농도(1~Full Range)	가스 별 상이
	ALM2(Alarm level 2)	Alarm 2 농도(1~Full Range)	가스 별 상이

5.3. Setting/Configuration Menu

	<p>Up/Down Key를 사용하여 내부 환경 설정 목록을 변경할 수 있다.</p> <p>- GAS/HART/MODT/ADR/PWD/C-TM/HIDN BRIT/M1.00/S1.00</p>
	<p>지원 가스</p> <p>▶ Select Key를 누르면 현재 지원 가스명 표시</p>
	<p>HART 장착 여부</p> <p>▶ Select Key를 누르면 현재 HART 지원이 가능 여부 확인 가능</p>
	





	
	<p>Modbus Type 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 RTU/TCP선택 ▶ Select Key로 변경 및 기기 재시작 후 적용
	
	<p>Modbus Address 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 1~64선택 ▶ Select Key로 변경
	
	<p>Password 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 00~99선택 ▶ Select Key로 변경

		
		<p>Calibration 주기 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 1~12개월 선택 ▶ Select Key로 변경
		
		<p>Hidden Area 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 0~20% 선택 ▶ Select Key로 변경
		
		<p>Brightness 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 1~15 선택 ▶ Select Key로 변경



		본체 버전 확인
		센서 카트리지 버전 확인






5.4. Setting/Measurement Menu

	<p>Up/Down Key를 사용하여 측정 설정 목록을 변경할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DECP/F-RN/UNIT
	<p>Decimal Point 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 1.000~1000 선택 ▶ Select Key로 변경

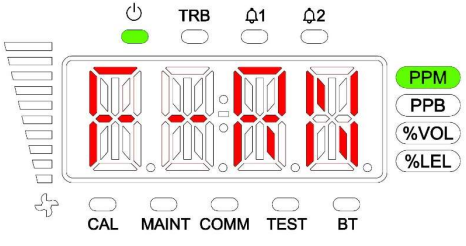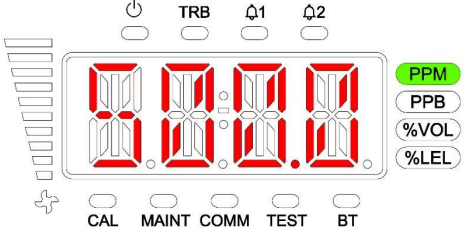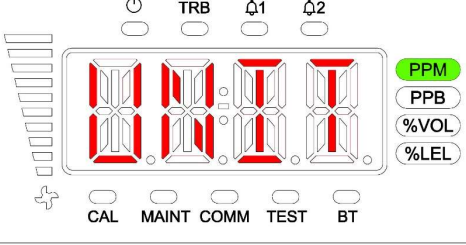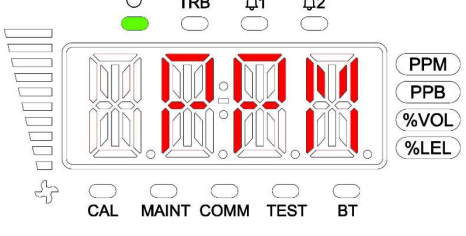
	Full Range 변경
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 1~9999 선택 ▶ Select Key로 변경
	Gas Unit 변경
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 PPB/PPB/VOL/LEL 선택 ▶ Select Key로 변경

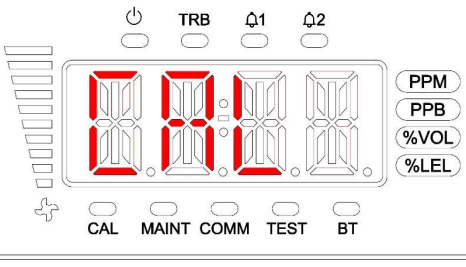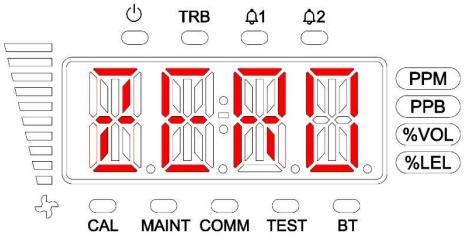
5.5. Setting/Calibration Menu

	<p>Up/Down Key를 사용하여 보정 설정 목록을 변경할 수 있다.</p> <p>- ZERO/S-CN/SPAN</p>
	Zero Calibration 변경
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ 센서 입력 값을 화면에 점멸 ▶ Select Key로 Zero 보정 수행

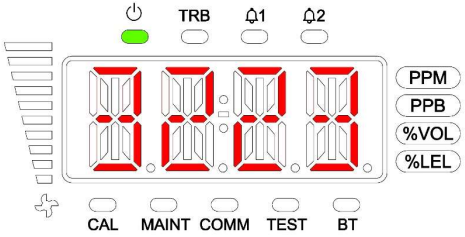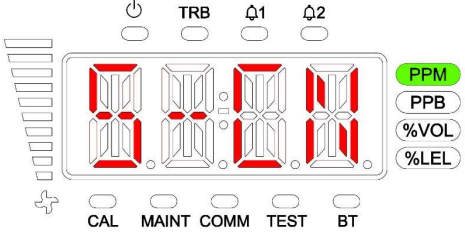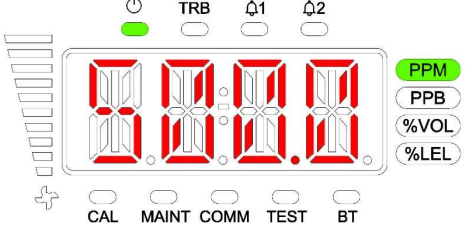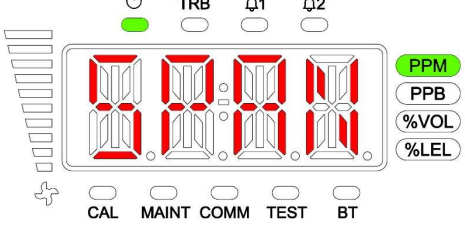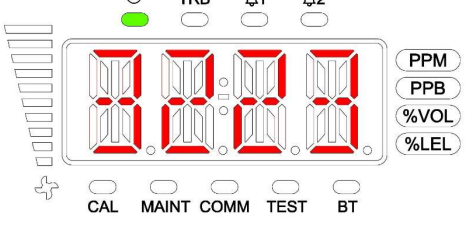 <p>The display shows a power icon, TRB, Q1, and Q2 indicators. The main menu has PPM, PPB, %VOL, and %LEL options. PPM is highlighted in green. Below the display are buttons for CAL, MAINT, COMM, TEST, and BT.</p>	
 <p>The display shows the Span Concentration menu with PPM, PPB, %VOL, and %LEL options. PPM is highlighted in green.</p>	<p>Span Concentration 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ Up/Down Key를 사용하여 1~9999 선택 ▶ Select Key로 변경
 <p>The display shows the Span Calibration menu with PPM, PPB, %VOL, and %LEL options. PPM is highlighted in green.</p>	
 <p>The display shows the Span Calibration menu with PPM, PPB, %VOL, and %LEL options. PPM is highlighted in green.</p>	<p>Span Calibration 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능 ▶ 센서 입력 값을 화면에 점멸 ▶ Select Key로 Span 보정 수행
 <p>The display shows the Span Calibration menu with PPM, PPB, %VOL, and %LEL options. PPM is highlighted in green.</p>	

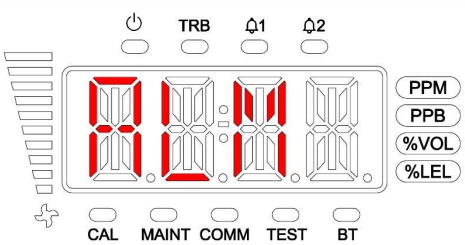5.6. Setting/Alarm Menu

 <p>The display shows the Setting/Alarm menu with PPM, PPB, %VOL, and %LEL options. PPM is highlighted in green.</p>	<p>Up/Down Key를 사용하여 보정 설정 목록을 변경할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LACH/ENER/DLY/ALM1/ALM2
---	--

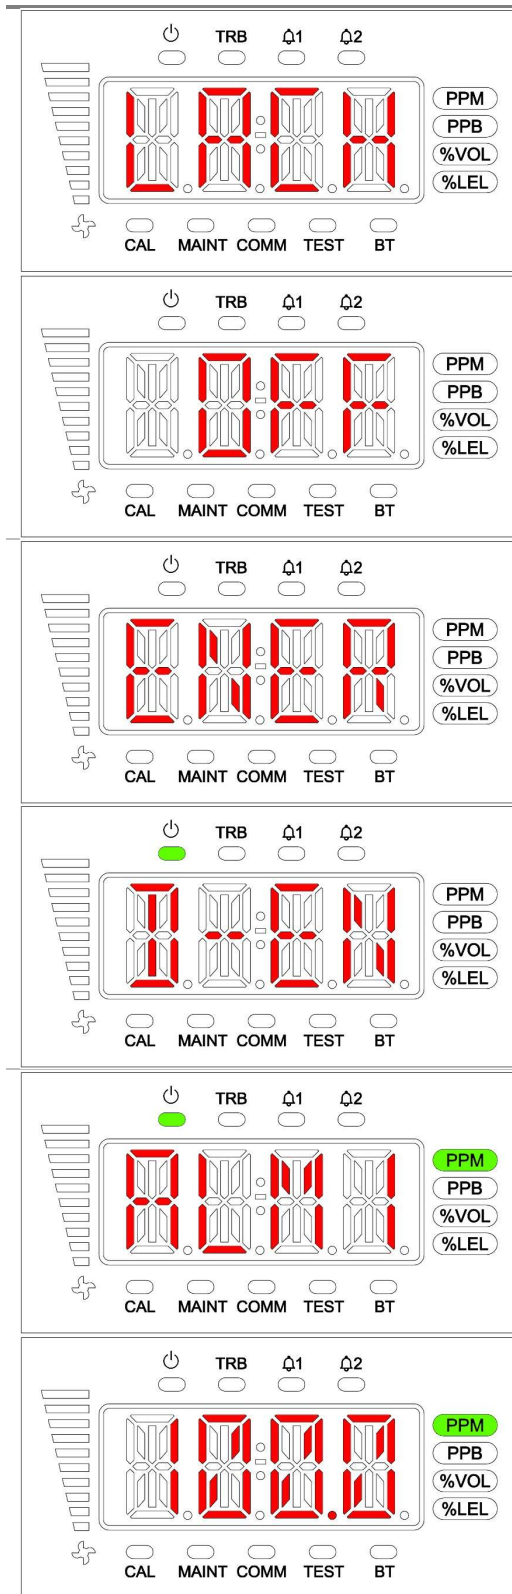

Alarm Latch 변경

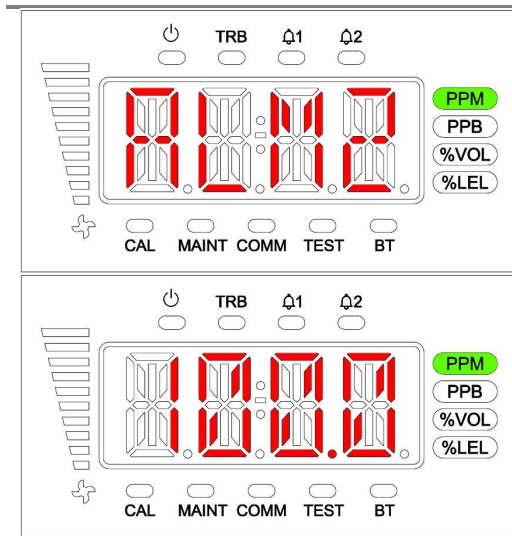
- ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능
- ▶ Up/Down Key를 사용하여 ON/OFF 선택
- ▶ Select Key로 변경

Alarm Energized 변경

- ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능
- ▶ Up/Down Key를 사용하여 D-EN/EN 선택
- ▶ Select Key로 변경

Alarm 1 Level 변경

- ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능
- ▶ Up/Down Key를 사용하여 1~9999 선택
- ▶ Select Key로 변경




Alarm 2 Level 변경

- ▶ Select Key를 눌러 변경 화면으로 진입 가능
- ▶ Up/Down Key를 사용하여 1~9999 선택
- ▶ Select Key로 변경

6. 문제 해결

6.1. Error code

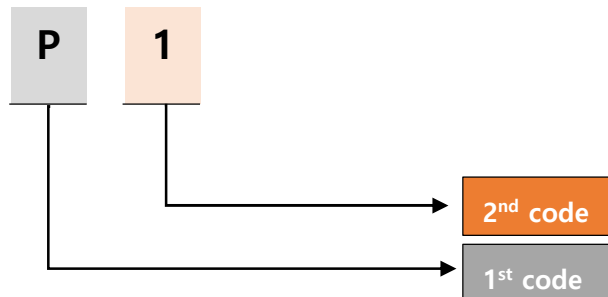Ex) Error Display Code



No	1 st Code	2 nd Code	원 인	해결방법
1	B	0	Firmware Version 이 비정상 적일 때	Firmware Update 실시
2	B	1	Firmware Tag 가 비정상 Data	Firmware Update 실시
3	B	2	Firmware CRC 가 비정상 Data	Firmware Update 실시
4	B	3	EEPROM Read/Write 실패	MAIN Board 교체
5	B	4	RTC Access 실패	MAIN Board 교체
6	Y	0	Pyrolyzer 전류 낮음	Pyrolyzer 연결 및 동작 상태 확인
7	Y	1	Pyrolyzer 전류 낮음	Pyrolyzer 연결 및 동작 상태 확인
8	S	0	Smart Sensor 통신 실패	Smart Sensor 연결 커넥터 확인 또는 교체
9	S	1	Smart Sensor 로부터 비정상 Data 수신	Smart Sensor 연결 커넥터 확인 또는 교체
10	S	2	Smart Sensor 수명 Expired	Smart Sensor 교체

11	S	3	Smart Sensor 농도가 비정상적으로 낮음	Smart Sensor 조립 상태 확인 또는 교체
12	S	4	Smart Sensor 농도가 비정상적으로 높음	Smart Sensor 조립 상태 확인 또는 교체
13	S	5	Smart Sensor 내부의 Sensor Error (PID Sensor 에만 적용)	Smart Sensor 내 Sensor 상태 확인 또는 교체
14	S	6	Smart Sensor Zero CAL 실패	Smart Sensor 내 Sensor 상태 확인 또는 교체
15	P	0	Pump 가 연결되지 않았거나 이상 동작	Pump 연결 상태 확인
16	P	1	Pump 압력이 비정상적으로 낮음	Pump 연결 상태 확인 및 배관 확인
17	P	2	Pump 압력이 비정상적으로 높음	Pump 연결 상태 확인 및 배관 확인
18	R	0	RS485 이상 동작	RS485 연결 상태 확인

7. Interface 구성

7.1 RS485 Interface setting

Baud rate: 9600 bps

Data Format: RTU

Data bits: 8bits

Stop bit: 1bits

Parity: None

기타 자세한 사항은 www.modbus.org 에서 참조 요망

7.2 TCP Interface setting

IP : 192.168.0.200(Default)

Subnet Mask : 255.255.0.0(Default)

Gateway : 192.168.0.1(Default)

기타 자세한 사항은 www.modbus.org 에서 참조 요망

7.3 MODBUS RS485/TCP Register

- 3010X Register Read

구분	Address	Bits	Description
측정가스 농도	30101	BIT15~0	가스 측정값(정수형/Decimal Point 적용 필요)

Gas Range	30102	BIT15~0	Gas Range(정수형/Decimal Point 적용 필요)
1차 Alarm 설정 값	30103	BIT15~0	1차 Alarm 설정 값(정수형/Decimal Point 적용 필요)
2차 Alarm 설정 값	30104	BIT15~0	2차 Alarm 설정 값(정수형/Decimal Point 적용 필요)
1차 Alarm Active	10001	BIT7~0	Alarm 1 Active 상태
2차 Alarm Active	10002	BIT7~0	Alarm 2 Active 상태
Fault Active	10003	BIT7~0	Fault Active 상태
Maintenance Mode	10004	BIT7~0	Maintenance Mode 상태
Test Mode	10005	BIT7~0	Test Mode 상태
Calibration Mode	10006	BIT7~0	Calibration Mode 상태
Decimal Point	10007	BIT7~0	Decimal Point(0~3)
Heartbeat	10008	BIT7~0	Heartbeat Bit(2초 간격 Toggle)

● 4000X Register Read

구분	Address	Bits	Description
Monitoring Status	40001	BIT0~3	0 : Warmup
			1 : Measure Mode
			2 : Inhibit Alarm
			3 : Inhibit Alarm/Fault
			4 : Inhibit Full
			5 : Reserved
			6 : Test Mode
			7 : 4-20mA Calibration Mode
			8 : Flow Calibration Mode
		9-15 : Reserved	
		BIT4	Fault Active Status
		BIT5	Reserved
		BIT6	Alarm 1 Active
		BIT7	Alarm 2 Active
		BIT8	Alarm 1 Relay energized
BIT9	Alarm 2 Relay energized		
BIT10	Fault Relay energized		
BIT11	Heartbeat Bit(2초 간격 Toggle)		
BIT12	Over Range		
BIT13	Span Calibration Due Date		

		BIT14	Sensor lifetime expired
		BIT15	Reserved
Cartridge Selection	40002	BIT0~7	Gas ID(Sensor Type)
		BIT8~15	Reserved
측정 가스 농도(실수)	40003	BIT0~15	실수형 가스 농도 측정값(상위 2byte)
	40004	BIT0~15	실수형 가스 농도 측정값(하위 2byte)
측정 가스 농도(정수)	40005	BIT0~15	정수형 가스 농도 측정값
Fault Code	40006	BIT0~15	Fault Code
Decimal Point and Units	40007	BIT0~2	Decimal Point Indicator(0~3)
		BIT3~7	Reserved
		BIT8~15	1 : ppb(농도 단위)
			2 : ppm(농도 단위)
			4 : % volume(농도 단위)
8 : %LEL(농도 단위)			
16 : mA			
온도 측정값	40008	BIT0~15	온도 측정값(Signed 16bit Integer)
Time Stamp	40009	BIT0~15	Current Time Stamp(상위 2byte)
	40010	BIT0~15	Current Time Stamp(하위 2byte)
Flowrate	40011	BIT0~15	Flowrate(cc/min)
Heartbeat	40012	BIT0~15	Detector Heartbeat
1차 Alarm 설정 값(실수)	40013	BIT0~15	실수형 Alarm 1 설정 값(상위 2byte)
	40014	BIT0~15	실수형 Alarm 1 설정 값(하위 2byte)
2차 Alarm 설정 값(실수)	40015	BIT0~15	실수형 Alarm 2 설정 값(상위 2byte)
	40016	BIT0~15	실수형 Alarm 2 설정 값(하위 2byte)
상태 값	40017	BIT0	Alarm 1 Active
		BIT1	Alarm 2 Active
		BIT2	Fault Active
		BIT3	Maintenance Mode
		BIT4	Test Mode
		BIT5	Calibration Mode
		BIT6	2차 Gas Type Detect(IPA, Galden등)
		BIT7	Cartridge Error
		BIT8	Flow Error
		BIT9	Internal Communication Error
		BIT10	Pyrolyzer Error
BIT11~15	Reserved		
Reserved	40018	BIT0~15	Reserved
Gas Range(실수)	40019	BIT0~15	실수형 Gas Range(상위 2byte)
	40020	BIT0~15	실수형 Gas Range(하위 2byte)

Detector Serial Number	40031	BIT0~7	Detector Serial Number 1/10
		BIT8~15	Detector Serial Number 2/10
	40032	BIT0~7	Detector Serial Number 3/10
		BIT8~15	Detector Serial Number 4/10
	40033	BIT0~7	Detector Serial Number 5/10
		BIT8~15	Detector Serial Number 6/10
	40034	BIT0~7	Detector Serial Number 7/10
		BIT8~15	Detector Serial Number 8/10
	40035	BIT0~7	Detector Serial Number 9/10
		BIT8~15	Detector Serial Number 10/10
Sensor Serial Number	40036	BIT0~7	Sensor Serial Number 1/10
		BIT8~15	Sensor Serial Number 2/10
	40037	BIT0~7	Sensor Serial Number 3/10
		BIT8~15	Sensor Serial Number 4/10
	40038	BIT0~7	Sensor Serial Number 5/10
		BIT8~15	Sensor Serial Number 6/10
	40039	BIT0~7	Sensor Serial Number 7/10
		BIT8~15	Sensor Serial Number 8/10
	40040	BIT0~7	Sensor Serial Number 9/10
		BIT8~15	Sensor Serial Number 10/10

● 4000X Register Write

구분	Address	Bits	Description
1차 Alarm 설정 값(실수)	40013	BIT0~15	실수형 Alarm 1 설정 값(상위 2byte)
	40014	BIT0~15	실수형 Alarm 1 설정 값(하위 2byte)
2차 Alarm 설정 값(실수)	40015	BIT0~15	실수형 Alarm 2 설정 값(상위 2byte)
	40016	BIT0~15	실수형 Alarm 2 설정 값(하위 2byte)
1차 Alarm 설정	40041	BIT15~0	*Alarm 1 설정 값(정수형/Decimal Point 없음)
2차 Alarm 설정	40042	BIT15~0	*Alarm 2 설정 값(정수형/Decimal Point 없음)
Reset Alarm & Fault	40043	BIT0	Reset Alarms and Faults
		BIT1~15	Reserved

* Decimal Point 2일 때 Alarm 0.25ppm을 설정하려면 $0.25 \times 10^2 = 25$ 로 하면 됨

* Decimal Point 1일 때 Alarm 30.0ppm을 설정하려면 $30.0 \times 10^1 = 300$ 을 설정하면 됨

8. Maintenance

Warning

- 검출기의 규정된 동작을 유지하기 위해서는 적절한 기준에 따라야 합니다.
- 올바른 작동을 위해 센서를 자주 Bump 테스트하는 것이 좋습니다.

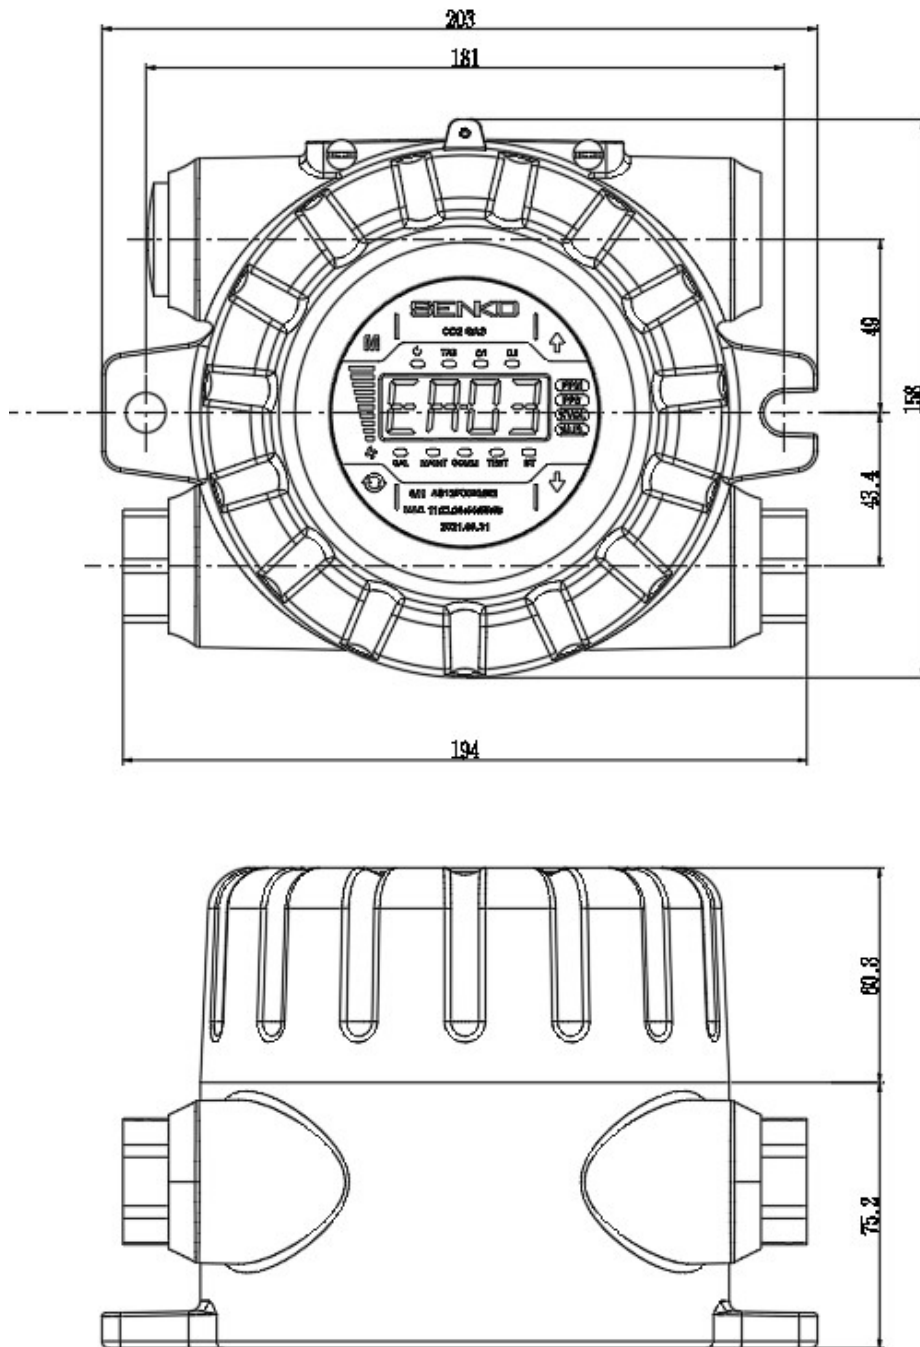
8.1 가스 테스트

시스템이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 센서를 자주 테스트하는 것이 중요합니다. 일반적으로 가스 감지기는 적어도 1년에 두 번 테스트해야 합니다. 그러나 센서 작동 및 성능이 다른 환경 조건 및 다른 가스의 존재에 따라 달라지므로 초기 시동 후 더 자주 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. 애플리케이션에 적합한 교정 빈도를 결정하는 것은 사용자의 책임입니다. 각 응용 프로그램에 대한 이 방법의 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.

8.2 감지기 작동 수명

독성 가스 센서의 일반적인 수명은 어플리케이션, 가스 노출 빈도 및 노출양에 따라 다릅니다.

9. 외형도 및 Dimensions



10. 설치 시 주의 사항

10.1 설치 장소의 선정

가스 누출 감지 경보기는 산업안전보건 법규 자료에 근거하여 설치하여야 할 장소는 다음과 같다.

- 건축물 내.외에 설치되어 있는 가연성 및 독성물질을 취급하는 압축기, 밸브, 반응기 배관 연결부위 등 가스의 누출이 우려되는 화학설비 및 부속설비 주변
- 가열로 등 발화원이 있는 제조설비 주위에 가스가 체류하기 쉬운 장소
- 가연성 및 독성물질의 충전용 설비의 접속부의 주위
- 방폭지역 안에 위치한 변전실, 배전반실, 제어실 등
- 그 밖에 가스가 특별히 체류하기 쉬운 장소

10.2 설치 위치의 선정

가스 누출 감지경보기는 가능한 한 가스의 누출이 우려되는 누출부위 가까이 설치하여야 하며, 다만, 직접적인 가스누출은 예상되지 않으나 주변에서 누출된 가스가 체류하기 쉬운 곳은 다음 각 호와 같은 지점에 설치하여야 한다.

- 건축물 밖에 설치되는 가스 누출 감지경보기는 풍향, 풍속 및 가스의 비중 등을 고려하여 가스가 체류하기 쉬운 지점에 설치한다.
- 건축물 안에 설치되는 가스 누출 감지경보기는 감지대상가스의 비중이 공기보다 무거운 경우에는 건축물내의 하부에, 공기보다 가벼운 경우에는 건축물의 환기구 부근 또는 해당 건축물내의 상부에 설치하여야 한다.
- 가스 누출 감지경보기의 경보기는 근로자가 상주하는 곳에 설치하여야 한다.

10.3 A/S 연락처

- 주소 : 경기도 오산시 외삼미로 15번길 73
- Tel : 031-8055-3758
- URL : <https://www.senko.co.kr/>

11. Certification

11.1 Related standards

- IEC 60079-0 : 2017
- IEC 60079-1 : 2014

12. 개정이력

No	항목	내용	Revision	개정일
1	최초 작성		Rev 1.0	2022.12.15

SENKO CO., LTD

www.senko.co.kr
senko@senko.co.kr